

CDigital Pregnancy Rapid Test

Immunochromatografie
Digitální těhotenský test
Diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro* pro sebetestování.
Návod k použití

SPECIFIKACE BALENÍ		
Model	Specifikace balení	REF
DC811	1 test/krabíčka	0811S7X001
	2 testy/krabíčka	0811S7X002

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Diagnostický prostředek *in vitro* slouží ke kvalitativnímu stanovení lidského choriového gonadotropinu (hCG) v lidské moči. Zdravotnický prostředek IVD určený k sebetestování v domácím prostředí. Vhodný pro včasnou diagnostiku těhotenství.

PRINCIP TESTU

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je glykoprotein produkovaný placentou během těhotenství, detekovatelný v moči těhotných žen. Tento test využívá laterální průtokovou imunoanalýzu a odraz světla pro detekci hCG ve vzorku z středního proudu moči.

hCG ve vzorku moči reaguje s konjugátem (anti-β-hCG monoklonální protilátka-koloidní zlatý konjugát) za vzniku sloučeniny. Jak kapalina proudí do testovací oblasti, sloučenina je zachycena anti-α-hCG protilátkou imobilizovanou na testovací ploše, poté se na testovací ploše vytvoří barevná čára. Testovací zařízení následně detekuje intenzitu světla použitím LED diody, díky čemuž se poté výsledek zobrazí na displeji. Test dokáže rychle a snadno provést včasnou diagnostiku těhotenství.

Hladiny hCG lze detekovat v lidské moči 7 až 10 dní po otehotnění.

OBSAH TESTOVACÍ SOUPRAVY

REF 0811S7X001:
1x Dr. Max Digital Pregnancy Rapid Test
1x Výsudec sáček
1x Návod k použití
REF 0811S7X002:
2x Dr. Max Digital Pregnancy Rapid Test
2x Výsudec sáček
1x Návod k použití
Materiály, které nejsou součástí balení: Odběrová nádobka na vzorek moči.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY A DOBA POUŽITELNOSTI

- Uchovávejte v suchu při teplotě 2–30 °C, nezmrazujte.
- Doba použitelnosti je 30 měsíců. Testovací zařízení použijte do 1 hodiny po otevření foliového sáčku.
- Datum výroby a datum použitelnosti jsou uvedeny na obalu výrobku.

POŽADAVKY NA VZOREK

Moč se odebírá pomocí odběrové nádoby nebo můžete vložit absorpční špičku testovacího zařízení přímo do proudu moči. U tohoto výrobku lze použít vzorek moči odebraný v kteroukoli denní dobu. Optimální je však první ranní moč.

Testování proveďte ihned po odběru moči. Pokud nelze test provést okamžitě, lze moč uchovávat při teplotě 2–8 °C, maximálně však dva dny. Před použitím vzorek nechte vytemperovat na pokojovou teplotu.







TESTOVACÍ METODA

Test provádějte za pokojové teploty.

- Vyjměte testovací zařízení ze sáčku a co nejdříve jej použijte, nepoždějte však do několika hodin.
- Proveďte buď test v proudu moči: Podržte absorpční špičku v proudu moči směrem dolů (Obr. 2). Pozor: Dávejte pozor, aby se zbytek testovacího zařízení nenamočil.
- Nemůžete provést test v odběrové nádobce: Po odebrání vzorku moči ponorte více než polovinu absorpční špičky do moči (Obr. 3). Pozor: Dávejte pozor, aby se zbytek testovacího zařízení nenamočil.
- Na displeji (Obr. 4) se objeví blikající symbol přesypacích hodin ⌚, čímž vás informuje, že test probíhá.
- Jakmile uslyšíte dvě pípnutí, vytáhněte testovací zařízení ze vzorku moči. Nasadte krytku a položte testovací zařízení na rovný povrch. Pozor: Nikdy nedržte testovací zařízení absorpční špičkou nahoru (Obr. 5).
- Do 5 minut zazní dvě pípnutí a výsledek se zobrazí na displeji.



Obr. 1 Části testovacího zařízení

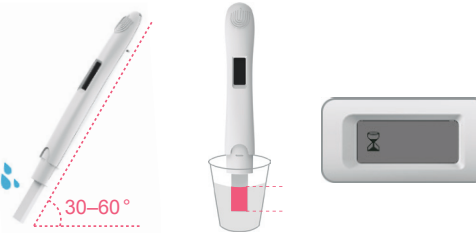

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Pokud se na displeji zobrazuje znak „+“ (pozitivní výsledek), znamená to, že jste pravděpodobně těhotná.

Negativní: Pokud se na displeji zobrazuje znak „-“ (negativní výsledek), znamená to, že patrně nejste těhotná.

Neplatný: Pokud se na displeji zobrazuje znak „⊘“ (neplatný test), test může být chybný nebo neplatný. Zkontrolujte, zda byl test správně proveden podle návodu k použití, a zopakujte test s použitím nového testovacího zařízení.



OMEZENÍ TESTU

- Tento výrobek je určen pouze pro testování hCG ve vzorku lidské moči.
- Staré nebo znečištěné vzorky moči, nebo vzorky obsahující nežádoucí příměsi, povedou k falešnému výsledku. Znečištěná odběrová nádobka nebo nesprávný postup také povedou k falešnému výsledku.
- Tento test se používá ke kvalitativní včasné detekci těhotenství. Kvantitativní výsledek by se měl ještě potvrdit jinými metodami.
- V některých případech mohou být výsledky testu zkresleny. Například: injekční aplikací nebo užíváním hormonálních či steroidních léků, u osob, které mají v anamnéze předchozí injekční aplikaci hCG, nádor vaječníků ze zárodkových buněk (OGCT), aj. V případě podezřelých výsledků se doporučuje test opakovat nebo potvrdit specializovanou laboratoří a provést komplexní vyšetření s příslušným lékařem nebo gynekologem.
- Hematurie, bilirubin v moči a zákal moči nemají vliv na výsledky testu. Vysoká přítomnost lipidů může ovlivnit výsledek testu.
- Pokud je hladina hCG příliš vysoká, může dojít k falešné negativnímu výsledku z důvodu omezení metody.

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

Senzitivita: 25 mIU/ml.

Specifita: Tento výrobek nevykazuje zkříženou reakci s luteinizačním hormonem (LH) (<500 mIU/ml), folikuly stimulujícím hormonem (FSH) (<1000 mIU/ml) a tyreotropním hormonem (TSH) (<1000 mIU/ml).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tento výrobek je určen pouze k vyšetření lidské moči *in vitro*.
- Tento výrobek je určen pouze na jednorázové použití. Použijte během doby použitelnosti. Test nelze použít opakovaně.
- Test je určen k použití ve vnitřních prostorech.
- Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a postupujte přesně podle pokynů, jinak budou výsledky testu nepřesné.
- Výsudec sáček ve foliovém sáčku je určen pouze pro účely skládání. Nepožívejte.
- Test nepoužívejte, je-li sáček propíchnutý nebo pokud není dobře utěsněn.
- Při použití dbejte na to, aby se moč nedostala do kontaktu s ostatními částmi testu kromě absorpční špičky, aby nedošlo k falešné negativnímu výsledku.
- Pokud se na displeji zobrazí symbol „⊘“, znamená to, že je test chybný nebo neplatný. Ujistěte se, že postupujete správně, a zopakujte test s použitím nového testovacího zařízení.
- Při běžném použití se po přidání vzorku zobrazí na displeji symbol přesypacích hodin. Pokud se tento symbol na displeji nezobrazí do jedné minuty po přidání vzorku, je dany test neplatný. Je potřeba test provést znovu s použitím nového testovacího zařízení.
- Za normálních okolností lze digitální hCG test použít 2 dny před očekávanou menstruací, nejdříve však 4 až 5 dní před očekávanou menstruací. Jakýkoli vzorek moči, odebraný v kteroukoli denní dobu, je vhodný na testování těhotenství. Optimální ale je, vzhledem k nejvyšší koncentraci hCG, vzorek ranní moči.
- Běžně používané léky (např. léky na nachlazení, antibiotika, léky proti bolesti atd.) nemají vliv na přesnost výsledků testu, ale injekční aplikace nebo perorální užívání léků na plodnost však výsledky ovlivňuje.
- Pozitivní výsledky testu mohou znamenat těhotenství. V případě pozitivního výsledku navštivte lékaře a požádejte o ověření těhotenství. Lékař vám poskytne informace a doporučí další postup. Tímto způsobem si zajistíte včasnou a optimální péči o vaše zdraví i zdraví vašeho plodu.
- Pozitivní výsledek obecně naznačuje těhotenství. Pozitivní výsledek však může nastat i v následujících případech: 1) U žen s abnormálním těhotenstvím, jako je mimoděložní těhotenství, u nevytlučeného, zamíhleného nebo neúplného potratu. 2) Nádory dělohy, molární těhotenství nebo vyšší hladiny hCG v moči u žen po menopauze. Lékař ověří těhotenství pomocí dalších vyšetření a testů v závislosti na anamnéze pacientky.
- Negativní výsledek testu znamená, že patrně nejste těhotná. Pokud se očekávaná menstruace nedostaví do jednoho týdne, proveďte test znovu. Pokud bude i druhý test negativní, navštivte lékaře.
- Pokud je výsledek testu negativní, ale existuje předpoklad těhotenství, opakujte test s ranní močí po 48–72 hodinách.
- Pokud je hladina hCG příliš vysoká (ve 2.–3. měsíci těhotenství) může nastat efekt prozóny (hook efekt) a výsledek testu může být negativní.
- Po použití otevřete kryt baterie na testovacím zařízení a vyjměte baterii (Obr. 1). Zlikvidujte výrobek v souladu s místními pravidly pro odpady a recyklaci. Baterii nerozbírejte, nenabíjejte a nevhazujte do ohně. Nepokýkejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytek testovacího zařízení zlikvidujte v souladu s místními pravidly recyklace pro elektrická zařízení. Elektrická zařízení nevhazujte do ohně.
- Během použití se doporučuje používat rukavice.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo návrhů během používání tohoto výrobku se obraťte na výrobce.

- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
- Č. dokumentu DC-IN-0811C01Ver 1.5 GB
Rel.: 2021/10/14
- Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3/4/5/7, Building A1, No.12, Nanyun 1st Road, Science City,
Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, Cina
Tel.: +86-020-82557192, service@dochekbio.com
www.dochekbio.com
- QbD RepS BV
Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
Belgie
- Dovozce:
Dr. Max Pharma s

 Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika		COLORS		SPECIALS		GLOSS VARNISH	MATT VARNISH	REMARKS
			Cyan					
NAME	Pregnancy test Comfort (CZ/SK/IT/PL/RO/RS) – PIL		Magenta					
BAR CODE	8595566428563		Yellow					
DIMENSION CUT	640 x 320 MM		Black					
DATE	16. 04. 2025							
ARTWORK SUPPLIER	GRADESI s.r.o.							